
FR

# X'PRESS

LIT X'PRESS (XO4)
LIT X'PRESS LOW (AG1)
LIT X'PRESS XXL (XA1)

**Notice d'utilisation**

MANUEL TECHNIQUE

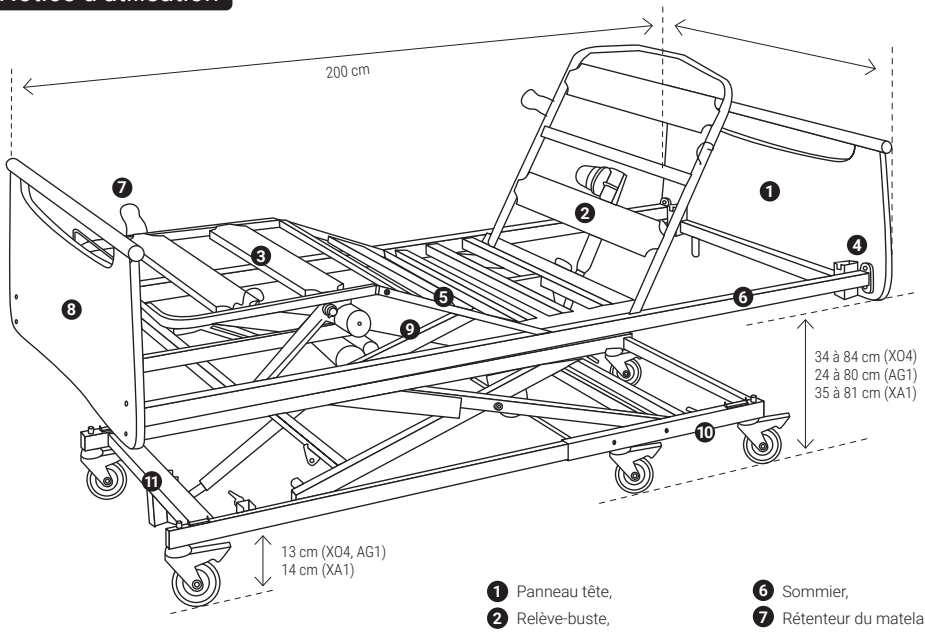


| Modèle | XO4 | AG1 | XA1 |
|---|---|---|---|
| (P/) | 12° | 12° | 15° |
| (C/) | 4° -16° | 15° -15° | 4° -16° |

1. Panneau tête,
2. Relève-buste,
3. Relève-jambes à crémaillère (C/)ou à plicature (P/),
4. Réservations potence d'angle,
5. Réservations tige porte sérum,
6. Sommier,
7. Rétenteur du matelas,
8. Panneau pied,
9. Croisillons,
10. Petite base,
11. Grande base,
12. Roues.

| Poids du dispositif | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | XO4 | AG1 | XA1 | |
| Largeur | 90 kg | 79 kg | 120 kg | 140 kg |
| (P/) | 72 kg | 90 kg | 81 kg | 122 kg |
| (C/) | 67 kg | 86 kg | 85 kg | 114 kg |

| Charge de fonctionnement en sécurité | | | |
|---|---|---|---|
| **170 Kg** XO4 / AG1 | | **315 Kg** XA1 | |
| **135 kg** patient | **35 kg** Matelas & accessoires | **270 kg** patient | **45 kg** Matelas & accessoires |

WIN CARE

CE

**580326**
Version 2026.01.05

**WINNCARE France**
4, Le Pas du Château,
85670 Saint-Paul-Mont-Penit
(France)

Tél. : +33 (0)4 66 02 15 15
Fax. : +33 (0)4 66 02 15 00
Email : contact@winncare.fr

**WINNCARE France**
4, Le Pas du Château,
85670 Saint-Paul-Mont-Penit
(France)

**www.winncare.fr**

*Photo/design non contractuel*

# 1. INDICATIONS

## Destination du dispositif
Compensation d'un handicap. Prévention.

## Indications
Le lit X'PRESS est indiqué chez l'adulte pour compenser l'altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques (déficience locomotrice des membres inférieurs et/ou supérieurs) ou de certains troubles de santé invalidants, et prévenir ou réduire des retentissements de l'immobilisation prolongée. Aider à la réalisation de soins, et la réalisation d'activités de la vie journalière.

## Groupe cible de patients et d'utilisateurs
Personnes dont la taille est supérieure ou égale à 146 cm, avec un poids supérieur ou égal à 40 kg, et un IMC supérieur ou égal à 17.

## Contre-indications
> A fixer par le médecin prescripteur.
> Poids et taille du patient différents de ceux fixés dans les conditions d'utilisation.

### Indiquer les effets secondaires indésirables

Informer l'autorité compétente si vous considérez ou avez des raisons de croire que le dispositif présente un risque grave ou est un dispositif falsifié.

# 2. COMPOSITION DU DISPOSITIF MÉDICAL

Bases, croisillons, sommier articulé et à hauteur variable, panneaux de tête et pied.

**Accessoires (option) :**

Tige porte sérum, supports de télécommande, butée murale, poignée d'appui, barrières bois, aide technique SAM, rallonge de sommier, potence d'angle, kit de transport, barrières ¾ métal, demi-barrières aluminium, barrière de pied de lit, lampe de lecture, tapis d'amortissement de chute, protections de barrière, kit de chargement.

Des accessoires, des panneaux et matelas associés, incompatibles peuvent créer des dangers. Seuls les accessoires et les panneaux distribués par WINNCARE France vous garantissent une compatibilité avec nos produits, et la conformité de l'ensemble marquage CE).

# 3. BÉNÉFICE CLINIQUE, PERFORMANCE

## Bénéfices cliniques escomptés
Préservation de l'état de santé du patient, de sa mobilité, de son activité, et de ses transferts. Réduction des retentissements du syndrome d'immobilisation. Protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs ou d'autres personnes.

## Performances du DM
**Vis-à-vis des patients :**

- Préservation ou amélioration de l'état physiologique et/ou psychologique (relève-buste, relève-jambe à plat),
- Aide fixe à la marche ou la mobilisation (panneaux, Système d'Aide à la Mobilité – en option),
- Aide à la prévention des escarres (relève-buste 30° et/ou positions fowler ou semi-fowler),
- Protection de la personne et/ou des aidants (barrières si prescrites à une fin médicale),
- Stabilité du matelas (butée latérale),
- Réduction de la gravité des chutes du lit (lit bas).

**Vis-à-vis des soignants et/ou aidants**

- Aide à la réalisation des soins (relève-buste, relève-jambe, à plat),
- Accès facilité à la tête et les pieds pour des soins spécifiques (panneaux de lits amovibles)
- Ergonomie et aide aux transferts (hauteur variable).

# 4. INSTRUCTION D'UTILISATION


## 4.1 Formation et qualification de l'utilisateur
La formation des utilisateurs doit être réalisée par des personnes formées et validées à l'utilisation du lit et accessoires, aux procédés et produits d'entretien désinfection.

## 4.2 Fonctionnement du dispositif
Faire un cycle d'essais à vide pour se familiariser avec les fonctions du lit.

### Freinage du lit


**Freinage individuel**

S'assurer du blocage des roues en essayant de déplacer le lit. Le non-respect de cette consigne peut engendrer la chute du patient ou d'une tierce personne lorsque celle-ci prend appui sur le lit.




### Mise en place des panneaux «Easy Move»

Monter le panneau le plus haut côté tête

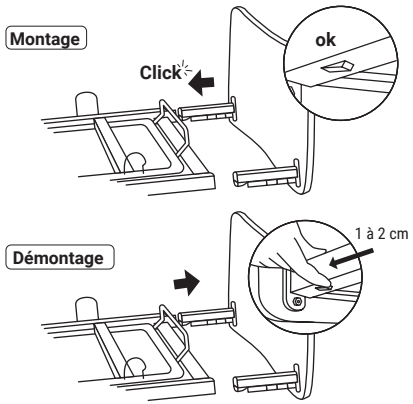


## Débrayage d'urgence du relève-buste

**(Cardio Pulmonary Resuscitation = CPR)**
**(option -B)**

Actionner une des deux poignées de débrayage situées sur le relève-buste tout en accompagnant la descente.

Tout relâchement de la poignée entraînera un arrêt du mouvement du relève-buste.

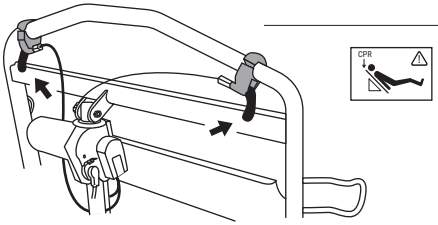



## Remise à plat du relève-buste sans CPR en cas de coupure de courant

**Version relève-buste sans poignée CPR**
En cas de panne, de coupure de courant ou pour remettre à plat le relève-buste (préconisation: manipuler à 2 aidants).

**A** Démonter le panneau tête ① en appuyant sur les systèmes («EasymoveTM») situés sous les long pans latéraux.

**B** Se positionner à la tête du lit et saisir le relève-buste ② d'une main. Pousser ou soulever le relève-buste pour compenser la pression exercée par le patient et de l'autre main défaire la goupille de sécurité ③ côté tige de poussée, le vérin du relève-buste va alors pivoter vers le bas.

**C** Accompagner la descente du relève-buste.

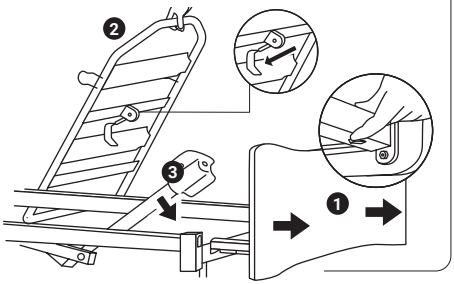


## Relève jambe

Relève jambe à crémaillère, ou à plicature (en option) avec ou sans mémoire de position.

## Barrières et Système d'Aide à la Mobilité (SAM)

Cf. notice d'utilisation des barrières de lits, et Systèmes d'Aide à la Mobilité consultables en ligne sur www.winncare.com.

### 4.3 Nettoyage et désinfection

Consulter le manuel technique.

### 4.4 Maintenance

La maintenance annuelle préventive du lit et de ses accessoires doit être réalisée au moins une fois par an par l'exploitant ou l'organisme qui l'a mis à disposition. Seuls les parties et composants d'origine distribués par WINNCARE France garantissent la sécurité et la performance du dispositif. La réparation des parties électriques est assurée exclusivement par notre fournisseur.
La durée de vie du lit médical (bases, croisillons, et sommier) est de 8 ans, et celle des accessoires et des panneaux est de 5 ans.

## 5. PRÉCAUTIONS D'EMPLOI, ET MISES EN GARDE

1. Les charges admises doivent être réparties uniformément sur la surface du sommier.
2. En charge, ne pas actionner simultanément tous les moteurs.
3. Freiner le lit après chaque utilisation, et lors des soins apportés au patient. Mettre le lit en position basse lors du repos du patient, afin de réduire la hauteur de chuteéventuelle d'une personne confuse ou agitée.
4. Lors d'un changement de position du lit, s'assurer qu'aucun objet/personne ne se trouve entre le lit et un composant du lit.
5. Ne pas s'asseoir sur le côté du relève-buste ou du relève jambes si ce dernier n'est pas à plat.
6. En cas de position semi-assise prolongée à plus de 50° d'inclinaison de buste, nous recommandons de faire varier la position de la personne alitée toutes les 2 heures.
7. Lors de toute manipulation, veiller à ne pas pincer les cordons électriques des moteurs et de la télécommande et de ne pas faire de noeuds. Les câbles ne doivent pas être en contact avec le sol ou les roues.
8. N'utiliser que des parties et composants d'origine distribués par WINNCARE France permettant de garantir la sécurité et de maintenir la conformité du produit.
9. L'état des câbles doit être vérifié régulièrement. Si la moindre altération est constatée ou qu'une intervention technique est nécessaire, la personne chargée de l'entretien du lit doit être contactée afin d'effectuer les réparations.
10. Une utilisation anormale du lit peut entraîner des risques de détérioration ou des incidents pour les utilisateurs (utilisation en extérieur ou transport du patient dans un véhicule, déplacement du lit sur une pente supérieure à 10°, s'asseoir sur le côté du relève-buste ou du relève-jambe).
11. Pour favoriser l'autonomie de la personne, il est possible d'adapter un Système d'Aide à la Mobilité (S.A.M).
12. La prise d'alimentation doit rester accessible pour permettre la déconnexion rapide du lit sans tirer sur le câble.
13. Le lit ne doit pas être utilisé pour le brancardage.
14. Ne pas laisser les télécommandes accessibles aux enfants.
15. Lors de tout changement de hauteur ou d'angle des parties du lit, s'assurer qu'aucun objet ou qu'aucune partie du corps du patient ou du personnel soignant ne se trouve entre le lit, panneaux, accessoires et le sol ou entre les panneaux et la base ou entre les croisillons.
16. (Ré)évaluer le risque de piégeage du patient dans les parties non mobiles du lit médicalisé associé aux barrières de lit et au matelas thérapeutique (norme EN 60601-2-52 pour les adultes).

## 6. EFFETS SECONDAIRES

Chute de la personne. Syndrome d'immobilisation. Aggravation de fracture(s) non stabilisée(s) et / ou douleur procédurale à l'activation des parties articulées du sommier.


**Signaler à votre médecin ou infirmier(e):**


- Tout évènement anormal après contact de la peau avec la surface des matériaux composants le lit et ses accessoires.
- Si les mesures requises concernant l'utilisation du dispositif médical ne peuvent pas être suivies.

Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

| | CONSEQUENCE | PRÉCONISATION |
|---|---|---|
| DANGER -> Piégeage | Mains pincées. | Manipuler le relève-jambes, le relève-buste par les poignées ou les barrières aux endroits spécifiés. |
| | Ecrasement corps ou objet. | Vérifier avant de descendre le lit en position basse que la zone entre le lit et le sol soit libre. |

## 7. STOCKAGE, MANIPULATION, ÉLIMINATION







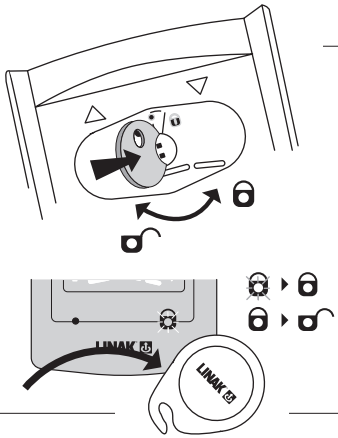

### Elimination

Consulter le fabricant et/ou le distributeur du dispositif.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Lire la notice d'utilisation et le manuel technique | LOT | Numéro de série |
| CE | Conforme au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux | SN | Numéro de lot |
| | Collecte séparée quand il est usagé | | Plage poids patient |
| | Attention, équipement électrique et électronique faisant l'objet d'une collecte sélective des déchets | | Avertissement |
| | Date de fabrication | | Nettoyage à sec exclu, usage de détachant à base de solvant exclu |
| CL ≤ 5000 ppm | Compatible avec solution de désinfection à base de Chlore (5000 ppm ou 0,5% de chlore actif) | | |

### Télécommandes

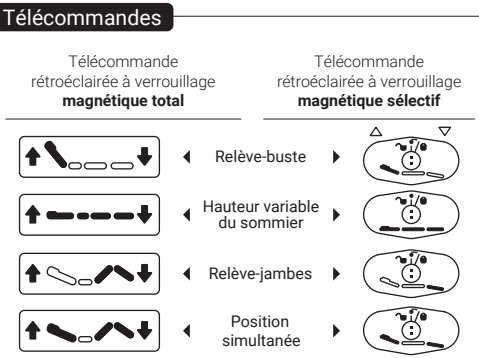


| CH | REP | Siotec AG, Untere Brühlstrasse 10,<br>CH-4800 Zofingen<br>CHRN-AR-20001368 |
|---|---|---|